Traducere din limba engleză

Sonde FiAPC sterile, cu filtru de siguranță

Protecție maximă împotriva contaminării

COAGULARE CU PLASMĂ DE ARGON

FiAPC

Siguranță în endoscopie intervențională

Coagularea cu plasmă de argon este o procedură endoscopică pentru a coagula zonele hemoragice și a devitaliza anomaliile tisulare. Pentru aplicarea în condiții de siguranță a APC în GIT, TBS și ORL, recomandăm sonda FiAPC - noua sondă cu filtru de siguranță.

Sondele FiAPC sunt disponibile în diferite versiuni (diverse lungimi și diametre) cu orificii axiale, laterale și circulare pentru fasciculul de plasmă. Sondele FiAPC sunt potrivite pentru utilizarea cu toate endoscoapele flexibile standard.

AVANTAJELE APC ÎN GASTROENTEROLOGIE SAU PNEUMOLOGIE

- ☑ Coagulare eficientă și rapidă în condiții de siguranță, chiar și în cazul unor zone extinse
- ☑ Adâncime de pătrundere limitată, poate fi, prin urmare, de asemenea, utilizată în zonele în care există un risc de perforare
- ☑ Carbonizare minimă, vindecarea optimă a leziunii
- ☑ Fără vaporizare, risc minim de perforare
- ☑ Cantitate redusă de fum, vizualizarea optimă a zonei vizate, mai puține mirosuri neplăcute
- ☑ Procedură fără contact, prin urmare fără aderența sondei de țesut
- ☑ Risc minim de deteriorare a stenturilor metalice
- ☑ Procedura este eficientă, în condiții de siguranță și ușor de învățat
- ☑ Echipament rentabil

Toate sondele APC sunt ajustate în mod optim pentru utilizarea cu sistemul VIO.

Aplicare flexibilă și multilaterală

Sondele APC au diferite duze de evacuare - laterale, axiale sau circulare - pentru coagulare APC precisă selectivă sau de suprafață, în funcție de țesutul vizat.

Exemplele includ coagulare de suprafață pentru ectazia venoasă gastrică antrală (GAVE) sau aspectul de pepene verde al stomacului, devitalizarea țesutului tumoral după creșterea spre interior a stentului în esofag, devitalizarea tisulară în papilomatoză traheală.

POSIBILE INDICAȚII ÎN GASTROENTEROLOGIE, PNEUMOLOGIE ȘI ORL

- ☑ Hemostază ale diferitelor indicații, de exemplu, hemoragie tumorală, hemoragie după procedură cu sondă bougie sau dilatare
- ☑ Devitalizare tisulară în tumori parțial stenozante sau zone tumorale parietale
- ☑ Devitalizare tisulară în tumori crescute spre interior sau a țesutului de granulație, după plasarea stentului (creștere spre interior și creștere excesivă)
- ☑ Devitalizarea țesutului tumoral în zonele în care există un risc de perforare

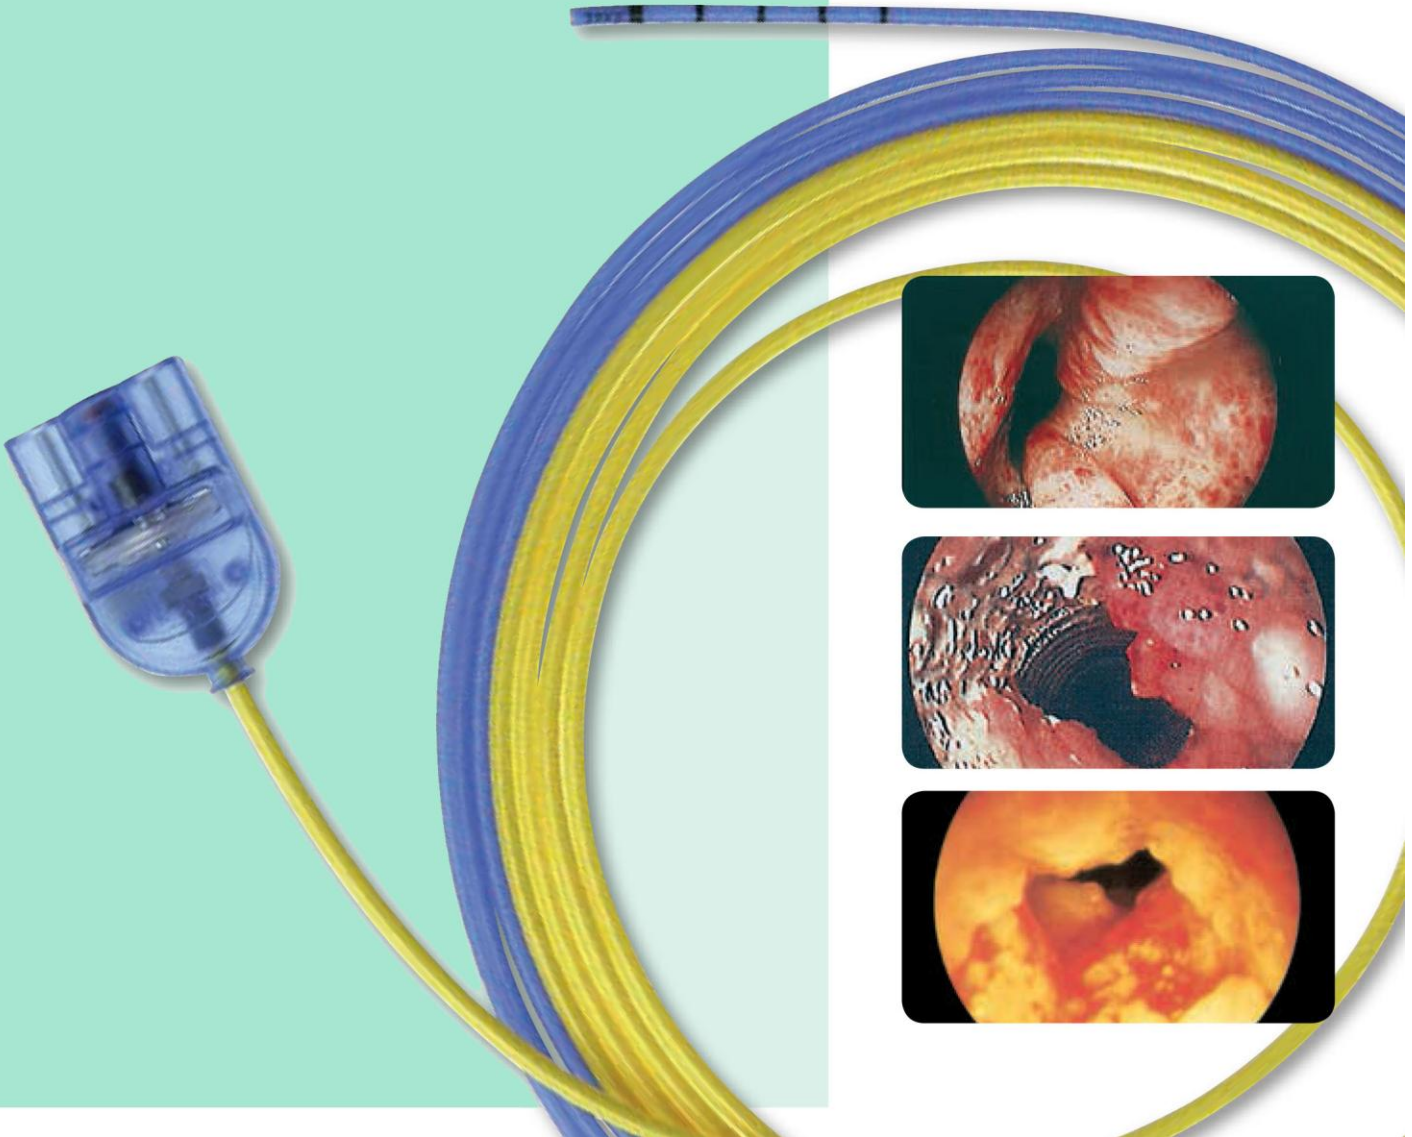

Avantaje

ale sondelor FiAPC

Cablul de conectare și filtrul sondei FiAPC sunt complet integrate în sondă ("all in one"). Sondele FiAPC de unică folosință pot fi utilizate imediat în sala de operație. Nu este nevoie de pregătirea cablului de conectare - ceea ce înseamnă lipsa costurilor de pregătire pentru cablu. Acest aspect reprezintă un preț semnificativ mai mic per aplicare APC, comparativ cu sondele APC standard de unică folosință. ”Plug and Play” (configurare automată) cu ușurință și mai ieftin.

Sondele FiAPC au proprietăți deosebit de bune de pornire.
Pentru chirurg acest lucru înseamnă că aplicările sunt mai sigure și mai convenabile.

Protecție împotriva contaminării

Un filtru cu membrană previne posibila contaminare a dispozitivului APC prin reflux sanguin sau secreții. Filtrul și cablul de conectare sunt ferm integrate în sonda APC. Prin această soluție all-in-one manevrarea sondei în sala de operație se efectuează cu mai multă ușurință. ”Plug and Play” este suportat prin detectarea de instrumente.

Sondele FiAPC sunt în conformitate cu recomandările de igienă pentru instrumentele endoscopice ale Institutului Robert Koch.

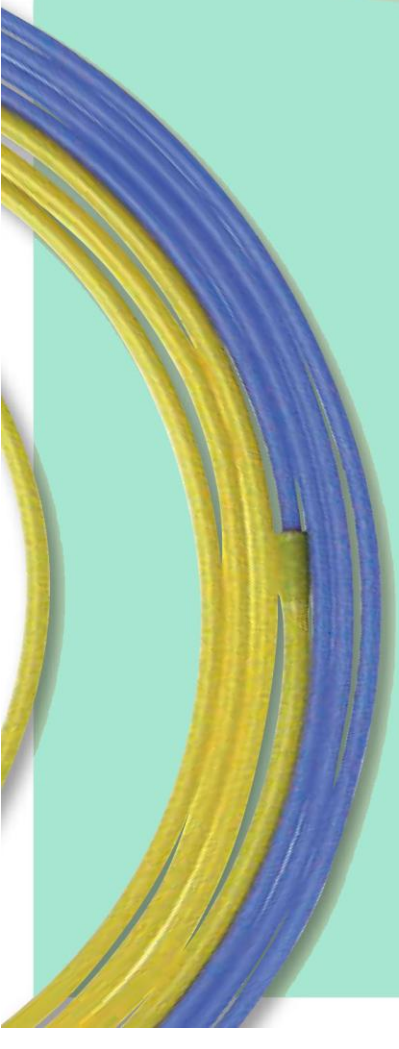

AVANTAJE PE SCURT:

- ☑ Nu este necesară pregătirea sondei sau a cablului
- ☑ Prin urmare, costuri mai mici per aplicare APC
- ☑ Nu este necesară înlocuirea filtrului de gaz
- ☑ Plug and Play
- ☑ Fără contaminarea unității

** Linii directoare privind reprocesarea endoscoapelor flexibile și ale accesoriilor endoscopice.*

Recomandările Comisiei privind Igiena în mediul spitalicesc și prevenirea infecțiilor, ale Institutului Robert Koch (RKI).

Bundesgesundheitsblatt 2002, 45:395–411; Springer Verlag.

Date tehnice ale sondelor FiAPC

Forme fascicul de lumină

Fascicul de lumină axial

Fascicul de lumină lat cu proiecție laterală



Fascicul de lumină conic cu proiecție laterală



Fascicul de lumină circumferențial



Sonde cu Ø 1.5 mm

Sondă FiAPC 1500 A, de unică folosință
Ø 1.5 mm/lungime 1.5 m
Nr. 20132-220

Sondă FiAPC 3000 A, de unică folosință pentru enteroscopie cu balon dublu
Ø 1.5 mm/lungime 3 m
Nr. 20132-226

Sonde cu Ø 2.3 mm

Sondă FiAPC 2200 A, de unică folosință
Ø 2.3 mm/lungime 2.2 m
Nr. 20132-221

Sondă FiAPC 2200 SC, de unică folosință
Ø 2.3 mm/lungime 2.2 m
Nr. 20132-224

Sondă FiAPC 3000 A, de unică folosință
Ø 2.3 mm/lungime 3 m
Nr. 20132-223

Sondă FiAPC 2200 C (circulară), de unică folosință
Ø 2.3 mm/lungime 2.2 m
Nr. 20132-225

Sonde cu Ø 3.2 mm

Sondă FiAPC 2200 A, de unică folosință
Ø 3.2 mm/lungime 2.2 m
Nr. 20132-222

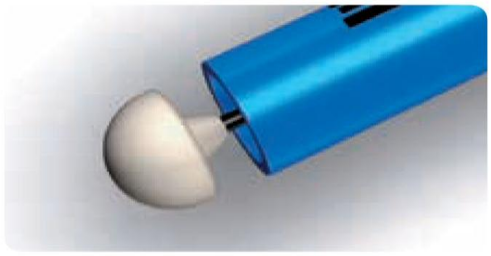

Sondă APC 2200, circulară

Sonda APC circulară a fost concepută pentru a permite un unghi radial de aplicare de 360° pentru aplicarea intraluminală optimă. Un alt avantaj devine evident în timpul manevrării: fasciculul APC coagulează țesutul cel mai apropiat. Nu este necesar să întoarceți sonda spre zona vizată.

Nu sunt necesare alte accesorii pentru sondele FiAPC.

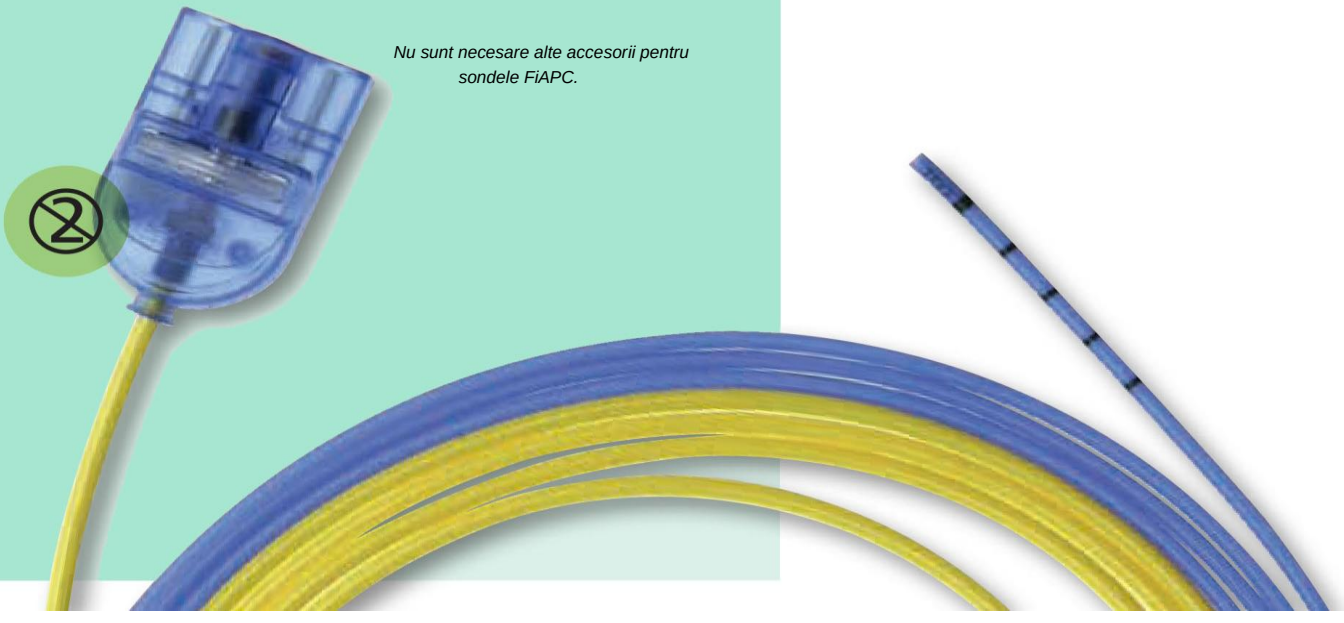

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Germania

Telefon +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2015 11.15 85100-140